

Wrocław, dnia 08.08.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr DZ/16/08/2024**na przygotowanie projektu, wykonanie, dostawę, montaż i podłączenie do wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, zlewów i armatury dla Pracowni Badań Technologicznych w budynku Cuprum NOVUM****SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****I. ZAMAWIAJĄCY:**

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław	
REGON: 930093846 NIP: 8960001770 Tel. +48 71 78 12 201, Fax +48 71 34 43 536 kghmcuprum.com kghm@kghmcuprum.com	<u>Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego</u> <u>Zapytania:</u> Bartłomiej Krzywicki e-mail: bartlomiej.krzywicki@kghmcuprum.com

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - a) wykonanie projektu i wykonanie/dostawa mebli laboratoryjnych, zlewów i armatury,
 - b) montaż i podłączenie przedmiotu zamówienia do wszystkich instalacji.
2. W załącznikach niniejszego zapytania znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. Poniżej wskazane załączniki wraz z opisem:
 - Załącznik 1: Wymagania ogólne i specyfikacja przedmiotu zamówienia.
 - Załącznik 2: Poglądowy rysunek układu mebli – rzuty ścian.
 - Załącznik 3: Technologia wyposażenia – układ funkcjonalny pracowni.
3. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia podzielona była na poszczególne etapy współpracy:
 - Etap I – Projektowanie;
 - Etap II - Produkcja, dostarczenie, montaż oraz podłączenie do wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, zlewów oraz armatury.Przed przystąpieniem do realizacji prac Etapu II konieczne jest wykonanie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającego projektu wykonawczego wraz ze szczegółowym opisem rozwiązań (Etap I), celem potwierdzenia zgodności wymagań Zamawiającego z wizją Wykonawcy.

Wykonawca dokona szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, w zakresie wykonania każdego mebla i w razie potrzeby doradzi najlepsze rozwiązania oraz wprowadzi konstruktywne poprawki do projektu. Po uzyskaniu akceptacji ww. dokumentów przez Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do dalszych prac realizowanych w Etapie II.

Wszystkie ustalenia z Etapu I między Zamawiającym a Wykonawcą przedmiotu zamówienia, muszą być ostatecznie potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem uzgodnieniowym.

4. Wymagania zamawiającego w zakresie realizacji usługi.
 - 4.1. Usługi określone przedmiotem zamówienia prowadzone będą w nowo wyremontowanych pomieszczeniach o powierzchni ok. 65 m² Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby nie dokonać uszkodzeń elementów wykończenia ścian i posadzek, będących w okresie gwarancji.
 - 4.2. Każdorazowo, po zakończonej pracy Wykonawca zobowiązany jest pozostawić miejsce montażu w stanie niepogorszonym i uprzątniętym.
 - 4.3. Miejsce realizacji zamówienia znajduje się w budynku Cuprum NOVUM przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
 - 4.4. Zamawiający wymaga aby przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Zawarte w zapytaniu wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
 - 4.5. Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Bartłomiej Krzywicki, nr tel. +48 71 781 22 83.
 - 4.6. Zamawiający na prośbę Wykonawcy umożliwi wgląd do dokumentacji technicznej pomieszczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 - 4.7. Przed zapoznaniem się z obiektem i dokumentacją konieczne jest podpisanie „Oświadczenia o zachowaniu poufności” stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.
 - 4.8. Wszystkie przestrzenie podbłatowe bez zabudowy szafkowej należy przewidzieć jako miejsca, do siedzenia a ich rozkład należy ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.
 - 4.9. Kolorystyka elementów mebli zostanie ustalona między Wykonawcą a Zamawiającym przed podpisaniem umowy, z palety barw oferowanej przez Wykonawcę, w kolorze jasnoszarym.
 - 4.10. Przez montaż wyposażenia należy rozumieć:
 - ✓ wniesienie wszystkich elementów zabudowy, szaf, stołów, zlewów i armatury do pomieszczeń;
 - ✓ zmontowanie elementów zabudowy;
 - ✓ ustawienie i wypoziomowanie elementów umeblowania;
 - ✓ podłączenie do istniejącej w budynku instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej oraz uruchomieniu i sprawdzeniu działania przedmiotu dostawy.
 - 4.11. Realizacja przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa, w tym budowlanego, przepisami BHP i PPOŻ, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.
 - 4.12. Wykonawca zapewni wszystkie materiały, urządzenia i robociznę niezbędną do realizacji przedmiotowych prac.
 - 4.13. Osoby realizujące prace powinny mieć uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotowymi pracami.
 - 4.14. Wykonawca zapewni nadzór nad pracami montażowymi związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez osoby odpowiedzialne za tworzenie projektu.
 - 4.15. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na bieżąco informacji odnośnie realizowanych prac.

7

- 4.16. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności i wykonać wszelkie zobowiązania, których zrealizowanie jest konieczne i niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4.17. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 4 lat przed upływem składania ofert, w wykonaniu minimum 3 zadań obejmujących wyposażenie pomieszczeń pracowni/laboratoryjnych o zbliżonych i/lub większych powierzchniach oraz zbliżonym stopniu złożoności co przedmiot oferty wraz z montażem, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 4 lata, w tym okresie.
- 4.18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 4.19. Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
- 4.20. Wykonawca powinien udzielić minimum 12-miesięcznej gwarancji oraz 24-miesięcznej rękojmi na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia, w tym na użyte materiały i poszczególne elementy mebli, osprzętu i armatury, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. Gwarancja powinna określać w szczególności, że:
- w przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia Dostawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia lub jego części, na nowy, wolny od wad, niezwłocznie, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia wykrycia;
 - w przypadku ujawnienia się wady przedmiotu zamówienia i stwierdzenia tej wady w okresie gwarancyjnym, okres gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzoną wadę, zostaje przedłużony o liczbę dni usuwania wady, tj. od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do usunięcia wady do daty skutecznego usunięcia wady;
 - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę).
- 4.21. Przedmioty objęte niniejszym zapytaniem powinny być fabrycznie nowe i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
- 4.22. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
- 4.23. Udział podwykonawców:
- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani.
 - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone poniżej kryteria.
- Kryteria wyboru oferty:
 - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu i nie zostały odrzucone z powodu niespełniania warunków określonych w niniejszym Zapytaniu,
 - Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów = 100%
 - Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- **Kryterium nr 1: Cena ofertowa** — rozumiana jako cena netto za całość przedmiotu zamówienia - waga kryterium 60 % (C) (maksymalnie 60 punktów)

$$C = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

- C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA
- C_{min} - najniższa cena spośród ofert
- C_{of} - cena oferty badanej

- **Kryterium nr 2: Gwarancja** — waga kryterium - 20 % (max. 20 punktów) (G). W kryterium gwarancja powinna być udzielona na okres min. 12 miesięcy na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia, w tym na użyte materiały i poszczególne elementy mebli, osprzętu i armatury, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis warunków gwarancji znajduje się w pkt II ppkt 4.20.

W ramach kryterium gwarancji punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

- okres gwarancji od 12 do 23 miesięcy – 5 pkt
- okres gwarancji od 24 do 35 miesięcy- 10 pkt
- okres gwarancji od 36 miesięcy– 20 pkt

- **Kryterium nr 3: Doświadczenie oferenta** - waga kryterium – 20 % (max. 20pkt) (D)

To kryterium będzie oceniane na podstawie liczby przedstawionego doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 4 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 4 lata, to w tym okresie, wykonali minimum 3 zadania obejmujące wyposażenie pomieszczeń pracowni/laboratoryjnych o zbliżonych i/lub większych powierzchniach oraz zbliżonym stopniu złożoności co przedmiot oferty wraz z montażem.

Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu wykonanych usług wraz z dołączonymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, zgodnie z poniższym podziałem:

- 3 udokumentowane zadania – 5 pkt.
- 4 udokumentowane zadania – 10 pkt
- 5 udokumentowanych zadań – 15 pkt.
- 6 i więcej udokumentowanych zadań – 20 pkt.

Zdobyta ilość punktów = C+G+D

Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach), ewentualnie Zamawiający spośród ofert może wybrać tę z najniższą ceną.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

maksymalnie do 9 tygodni od daty podpisania umowy,
przy czym realizacja Etapu I nie może być dłuższa niż

do 2 tygodni od dnia podpisania Umowy;

Miejsce realizacji zamówienia:

KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na Formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4** oraz wymaganymi Załącznikami do niniejszego Zapytania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna:

1. Zawierać wycenę wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, sporządzoną w oparciu o wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
4. Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona w PLN.
5. Zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.
6. Zawierać Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiących integralną część Formularza ofertowego będącego Załącznikiem nr 4 do Zapytania. Do oferty należy dołączyć dokument świadczący o należyтым wykonaniu minimum 3 zadań obejmujących wyposażenie pomieszczeń pracowni/laboratoryjnych o zbliżonych i/lub większych powierzchniach oraz zbliżonym stopniu złożoności co przedmiot oferty wraz z montażem, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 4 lata, to w tym okresie.
7. Zawierać Oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (jeśli dotyczy).
8. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z informacjami ujawnionymi w ewidencji lub rejestrze właściwym dla działalności Wykonawcy lub zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem w tym zakresie. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby podpisującej.
9. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwej ewidencji lub rejestru odpowiedniego dla prowadzonej działalności Wykonawcy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru. Odpis powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru jest powszechnie dostępne (jeśli dotyczy).
10. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy obligatoryjnie dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji Wykonawcy w tym zakresie.
11. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian na uprzednio przygotowaną treść oferty po upływie terminu do jej złożenia.
12. Zawierać ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia o wartości, co najmniej 200.000,00 zł.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

1. Oferty składa się w formie elektronicznej w postaci dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym bądź ePUAP na adres: przetargi@kghmcuprum.com; E-mail, należy zatytułować: „Oferta na przygotowanie projektu, wykonanie, dostawę, montaż i podłączenie do wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, zlewów i amatury dla Pracowni Badań Technologicznych”

Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów podpisanych dokumentów, zastrzegając możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia oryginałów w celu weryfikacji.

Termin składania ofert: do 23.08.2024 r. do godz. 08:00

(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.

VII. ROZSTRZYGNIECIE/WYBÓR OFERTY

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.08.2024 r. o godz. 08:30**. Wykonawca wybranej oferty zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania i wyborze jego oferty.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu w sposób analogiczny do ogłoszenia niniejszego Zapytania.

Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę ostatnia złożona oferta przez Wykonawcę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

Forma i zasady porozumiewania się:

- 1) Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert na adres e-mail bartlomiej.krzywicki@kghmcuprum.com
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem, a także poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty. Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszego Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz poinformuje drogą elektroniczną o tym Oferentów, którym przekazano niniejsze Zapytanie.
- 5) Jeżeli w wyniku zmiany treści w niniejszym Zapytaniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców, którym przekazano niniejsze Zapytanie.

4

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenia stosownych uprawnień przed realizacją zamówienia.
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawiają wykaz potwierdzający, że w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 4 lata, w tym okresie wykonali z należytą starannością minimum 3 zadania obejmujące wyposażenie pomieszczeń pracowni/laboratoryjnych o zbliżonych i/lub większych powierzchniach oraz zbliżonym stopniu złożoności co przedmiot oferty wraz z montażem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie wykaz ww. usług oraz przedstawił referencje lub inne dokumenty świadczące o należytej wykonanej usłudze;
- c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) znajdują się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- e) nie są prowadzone w stosunku do nich postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaje w upadłości;
- f) nie zalegają ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS (jeśli dotyczy);
- g) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
- h) posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł lub inne poręczenie gwarancyjne wraz z dowodem uiszczenia składki

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w formularzu ofertowym. Złożenie podpisu pod oświadczeniem, przedstawienie wykazu usług oraz dołączenie dokumentów świadczących o należytej wykonanej usłudze zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunek posiadania polisy ubezpieczeniowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach opisanych wyżej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Wymóg opłacenia składki ubezpieczeniowej powinien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie-spełnia”

X. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w **Załącznik nr 5** do niniejszego Zapytania.

XI. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która:
 - a. jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub
 - b. jest niekompletna, tj. nie zawiera dokumentów i/lub oświadczeń wymaganych niniejszym Zapytaniem (pkt V.) pomimo wezwania do uzupełnienia lub
 - c. zawiera nieprawdziwe informacje lub
 - d. w stosunku do której Oferent nie złożył wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z żądaniem lub
 - e. w stosunku do której Zamawiający wystosował wezwanie do przedłożenia dokumentów, o którym mowa w pkt V. niniejszego Zapytania, a Wykonawca nie odpowiedział na to wezwanie, zgodnie z jego treścią,
 - f. została zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert,
 - g. została złożona po upływie terminu składania ofert.

XII. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

1. Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru za całość przedmiotu zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego związanych z wadami przedmiotu zamówienia, w tym roszczeń z rękojmi lub gwarancji.
3. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieupublicznych informacji oraz treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania lub o których uzyskał wiedzę w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje przez okres 5 lat od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzania części zamówienia podwykonawcom.
9. Warunki płatności za wykonana usługę Etapu I i Etapu II łącznie – przelew 30 dni.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. gdy cena ofertowa znacznie odbiega od cen rynkowych lub budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Komisja zwraca się do Wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące uwiarygodnienia kalkulacji ceny w celu ustalenia możliwości należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia, chyba że jest to oczywiście zbędne.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy:
 - a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
 - d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12. W przypadku oczywistych omyłek w ofercie, które nie powodują istotnych zmian w jej treści, dopuszcza się ich poprawienie i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od poprawienia omyłek oraz wzywania do uzupełnienia i wyjaśniania ofert, o ile nie będzie to miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
 13. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
 14. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Wykonawcami.
 16. Powiadomienie o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie oznacza jej przyjęcia. Warunki, na których jest dokonywany zakup, są potwierdzane poprzez podpisanie Umowy z Wykonawcą lub złożeniem Zamówienia. Zamawiający ma prawo nie podpisać Umowy z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza, bądź nie złożyć u niego podpisanego Zamówienia.
 17. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
 18. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i jego reprezentanci oraz jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.
 19. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem się z Polityką Antykorupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie, <https://kghmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcyjna-kghm-cuprum-sp-z-o-o-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.
 20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU ZWIĄZANYM Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,

- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kghmcuprum.com
- 3) Administrator Danych Osobowych przetwarza:
 - a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciężących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem.
 - b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy.
 - c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy.
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- 5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - b) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących; o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
- 9) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 - Wymagania ogólne i specyfikacja przedmiotu zamówienia.
- Załącznik nr 2 - Poglądowy rysunek układu mebli – rzuty ścian
- Załącznik nr 3 - Technologia wyposażenia – układ funkcjonalny pracowni.
- Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Kierownik
Działu Zakupów

Alicja Niedziela

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA OGÓLNE:

Meble zgodne z normą PN-EN 13150 lub równoważną.

Wymaga się przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich atestów i certyfikatów.

Wszelkie elementy wyposażenia należy przedłożyć zamawiającemu do ostatecznej akceptacji.

Ilość oraz rozmieszczenie gniazd wtykowych i komputerowych zamontowanych w blatach stołów laboratoryjnych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w poniższej specyfikacji. Dokładną lokalizację poszczególnych gniazd wbudowanych w blaty stołów laboratoryjnych oraz ich ilość należy przedłożyć Inwestorowi do ostatecznej akceptacji, na etapie realizacji.

1. KONSTRUKCJA NOŚNA (STELAŻ)

Konstrukcja nośna stołów laboratoryjnych oparta na stelażu stalowym typu C lub A. Konstrukcja stelaża wykonana ze stalowych profili zamkniętych o przekroju min. 50x30x3 mm. Rodzaje stelaży na poszczególnych stanowiskach opisano w specyfikacji stanowisk.

Inne stelaże – tylko jeśli opisano.

Nie dopuszcza się stelaża wykonanego z kształtowników o grubości < 3 mm.

Nogi stelaża wyposażone w stopki, umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-20 mm.

Stelaże w całości malowane proszkowo chemoodporną farbą poliestrową lub epoksydową, w kolorze jasnoszarym wg wzornika RAL – RAL 7047.

Stelaże stołów skonstruowane tak, aby spoczywające na nich blaty były podparte na całym obwodzie.

Konstrukcja stelaża C pozwalająca na podwieszanie modułów szafkowych.

Prześwit pomiędzy podłogą, a szafkami podwieszanymi - min. 150 mm.

Otwarte końce kształtowników stelaży, zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego o barwie harmonizującej z barwą mebli.

2. SZAFY, SZAFKI, REGAŁY

Wykonane z płyt obustronnie laminowanych o klasie higieniczności E1, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 1 mm.

Kolor płyt obustronnie laminowanych – RAL 7047 lub zbliżony – do akceptacji Zamawiającego.

Tyłna ściana szafek i szaf wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 10 mm.

Fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej.

Spody szuflad z płyty laminowanej o grubości min. 10 mm.

Prowadnice szuflad powinny posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem, pełny wysuw, funkcję cichego domykania. Prowadnice powinny jednocześnie stanowić podwójne metalowe boki. Dopuszczalne obciążenie szuflad do 40 kg.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

Uchwyty szafek i szuflad monolityczne wykonane z pręta ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo. Długość uchwytów nie większa niż 250 mm.

Szafki z drzwiami wyposażone w jedną półkę, chyba że w zestawieniu asortymentowym wskazano inaczej. Wszystkie krawędzie półek wykończone okleiną PCV gr. min. 1 mm. Półki zabezpieczone przed przypadkowym wypadaniem.

Zawiasy z powłoką galwaniczną z funkcją otwarcia minimum 95°, z funkcją cichego domykania.

Głębokość szafek dostosowana do wymiarów stołów, minimum 500 mm. W miejscach gdzie zlokalizowano zlewki głębokość szafek musi umożliwiać montaż zlewów.

Zamki – tam, gdzie opisano.

3. BLATY LABORATORYJNE

Blaty z żywicy fenolowej o grubości min. 19 mm. Kolor jasnoszary, zbliżony do NCS S 1000N.

Blaty wykonane z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej, o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału, nie dopuszcza się blatów klejonych z 2 warstw.

Blaty w wersji z podniesionym obrzeżem mają posiadać dedykowane doklejone obrzeże wykonane z żywicy fenolowej.

Blaty o co najmniej dobrej odporności chemicznej, mechanicznej i odporności na wilgoć. Bardzo dobra odporność mikrobiologiczna i UV.

Powyższe blaty wykonane z żywicy fenolowej powinny posiadać następujące certyfikaty i atesty:

- Atest higieniczny,
- Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

4. NADSTAWKA LABORATORYJNA

Konstrukcja nadstawki oparta na systemie trzech kolumn wykonanych z profili aluminiowych lub stalowych porytych techniką proszkową farbami chemoodpornymi.


W kolumnach umieszczone gniazda elektryczne 230 V (w tym DATA) o klasie szczelności min. IP44, po połowie na każdą ze stron i gniazda LAN do podłączenia kabla internetowego.

Całkowita wysokość nadstawki wynosząca min. 750 mm.

Półki ze szkła bezpiecznego powinny być osadzone w ramkach lub na ramkach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową. Brzeg ramek wystający powyżej półek szklanych, co ma stanowić zabezpieczenie przed przypadkowym spadaniem przedmiotów stojących na półkach.

Wszystkie instalacje elektryczne, które będą prowadzone przez Wykonawcę w przestrzeni instalacyjnej stołu wyspowego i nadstawki muszą być prowadzone w odpowiednich kanałach (plastikowych karbowanych rurach elektroinstalacyjnych), zapobiegających uszkodzeniom mechanicznym przewodów, a także w celu zabezpieczenia przed bezpośrednim kontaktem z metalową konstrukcją mebla.

Pod dolną półką musi się znajdować oświetlenie LED z możliwością niezależnego uruchamiania każdej sekcji. Stół musi być wyposażony w 2 włączniki dotykowe umożliwiające wyłączenie oświetlenia z każdej strony stołu wyspowego oddzielnie.

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.


5. ZLEWY LABORATORYJNE

Blaty z żywicy fenolowej o grubości min. 19 mm, podniesione obrzeże dookoła blatu – tak jak wskazano w specyfikacji.

Zlewy ceramiczne o wysokiej odporności na czynniki chemiczne; odporne na substancje agresywne w tym rozpuszczalniki organiczne, stężone kwasy i zasady oraz inne substancje.

Wymiar zlewu (miski) – jak opisano w specyfikacji.

Kolory zlewów ceramicznych – jak opisano w specyfikacji.

Na stanowiskach do zmywania głębokie zlewy dodatkowo podparte – zaznaczono w specyfikacji.

Preferowany sposób montażu zlewów: podklejany lub wpuszczany.

6. ARMATURA LABORATORYJNA

Armatura laboratoryjna zamontowana w blacie stołu laboratoryjnego.

Wymagane jest, aby armatura laboratoryjna pokryta była farbą na bazie żywic poliestrowych lub farbami epoksydowymi w kolorze jasny popiel.

Kody barwne powinny być zgodne z normą PN-EN 13792:2003.

Baterie laboratoryjne na stanowiskach do zmywania – stanowiska B5, B6 (2 szt.):

- montowane na blacie,
- bateria z dźwignią nad wylewką, uchwyt wydłużony, umożliwiający obsługę łokciem,
- bateria z mieszaczem do wody ciepłej / zimnej,
- wylewka ruchoma, o wysokości nad blatem: w zakresie 250 mm – 300 mm,
- długość wylewki: w zakresie 250 mm – 300 mm,
- zakończenie wylewki: perlator,
- materiał wykonania: mosiądz

Zdjęcie poglądowe obok.



Armatura laboratoryjna w blacie stołu laboratoryjnego – stanowiska B1.1, B3, B4, B7 (4 szt.):

- montowane na blacie,
- bateria laboratoryjna stojąca do wody zimnej wykorzystywana w laboratoryjnych stanowiskach wyspowych lub przyściennych ze zlewikami.
- wysokość baterii: 300 – 350 mm,
- długość wylewki: 140 – 160 mm,
- zakończenie wylewki: standardowo „oliwka” do węża,
- materiał wykonania: mosiądz,
- montaż: na stole,
- przyłącze zasilania: 1/2"
- kolor: szary – chemoodporna farba epoksydowa



Zdjęcie poglądowe obok.

Syfony zlewozmywakowe do zlewu jednokomorowego do przyłączania zlewozmywaków z jedną miską; zgodność z normą EN 274-3; syfon rurowy; materiał: tworzywo sztuczne; d, średnica = 50 mm; G = 1 91/2"; w zestawie: - króciec przyłączeniowy z nakrętką z PP, G = 1 1/2"; - rozетка, - syfony dostosowane do wskazanych w specyfikacji zlewów.

7. OCZOMYJKA

Oczomyjka podwójna, montowana w blacie, spełniająca wymogi normy PN-EN 15154-2.

8. KRZESŁA LABORATORYJNE

Wysokość krzeseł regulowana, krzesła do pracy przy blacie o wysokości h = 90 cm.

Krzesło wysokie komputerowe – przy stanowiskach komputerowych (K1, 2 szt.):

- regulacja wysokości,
- tapicerowane siedzisko,
- siatkowe oparcie,
- siatkowy zagłówek,
- podłokietniki z regulacją wysokości,
- regulowany podnóżek pod stopy,
- obrotowe,
- z kółkami,
- w kolorze szaro-czarnym.



Zdjęcie poglądowe obok.

Krzesła przy wyspie (K2, 6 szt.)

- krzesło laboratoryjne wysokie,
- z oparciem,
- z regulacją wysokości siedziska,
- z regulowanym podnóżkiem pod stopy,
- obrotowe,
- podstawa krzesła wykonana z chromowanej stali,
- na nóżkach,
- w kolorze czarnym.



Zdjęcie poglądowe obok.

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA STANOWISK:

SYMBOL*	SPECYFIKACJA	ILOŚĆ	MONTAŻ	PODŁĄCZENIA
B1	<p><u>STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLATEM LABORATORYJNYM CHEMOODPORNYM I SZAFKAMI POD BLATEM</u> - wymiary blatu: szer.: 300 cm; gł.: 75 cm; wys.: 90 cm; - blat z żywicy fenolowej o grubości min. 19 mm, - stelaż metalowy typ C, lakierowany proszkowo, regulowane stopki; - stanowisko do pracy przy komputerze o szer. 800 mm, zgodnie z ZAŁ. 2; - pod blatem szafki podwieszane o szer.: 600 mm - 3 szuflady (równej wysokości) (z zamkami) x 1 szt. 500 mm - 1 drzwi (z półką) x 2 szt. 600 mm - 1 drzwi (z półką) x 1 szt.; - blat umożliwiający poprawne działanie żaluzji zamontowanych na oknie (ok. 10 – 11 cm odsunięcie blatu od okna).</p> <p>Poglądowe rozmieszczenie mebli zawarto na schemacie stanowiącym ZAŁ. 2.</p>	1	STAŁE	
B1.1	<p><u>STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLATEM LABORATORYJNYM CHEMOODPORNYM</u> - wymiary blatu: szer.: 180 cm; gł.: 100 cm; wys.: 60 cm; - blat z żywicy fenolowej o grubości min 19 mm, - stelaż metalowy typ A, lakierowany proszkowo, profil min. 50x30x3 mm, regulowane stopki, - pod blatem zamontowana szuflada o wysokości do 15 cm i głębokości umożliwiającej montaż przyłączy na stanowisku (poglądowo ZAŁ. 2). + <u>ZLEW CERAMICZNY ZAINSTALOWANY NA BŁACIE (POD ŚCIANA)</u> - lokalizacja zlewu i baterii zgodnie z ZAŁ. 3 - zlew ceramiczny laboratoryjny - wymiary wewnętrzne (komora zlewu): długość: od 250 do 300 mm, szerokość: od 90 do 120 mm, głębokość: od 100 do 120 mm; - z syfonem; - kolor: szary; - nad zlewem bateria nablátowa zgodnie ze specyfikacją z wymagań ogólnych. + <u>PÓŁKA WISZĄCA O WYM.: 70x30 cm (P1)</u> - wykonana z takiego samego materiału jak blaty robocze: żywica fenolowa;</p>	1	STAŁE	<p>PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ; ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW;</p>

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

	<ul style="list-style-type: none"> - zamontowana na wysokości 130 cm (spód półki) od posadzki; - sposób montażu półki umożliwiający poprowadzenie przewodów montażowych pomp pomiędzy półką a ścianą; - listwa LED wfrezowana w dolną płaszczyznę półki. <p>Poglądowe rozmieszczenie mebli zawarto na schemacie stanowiącym ZAŁ. 2.</p>			
B2	<p><u>STÓŁ WAGOWY ATYWIBRACYJNY POJEDYNCZY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer. 90 cm; gł.: 75 cm; wys.: 90 cm; - stelaż spawany w całości z profili stalowych min. 50x30x3 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi; - obudowa stołu wykonana z płyt o grubości min. 18 mm; - obudowa bez punktów styčných ze stelażem; - 1 x kamień o wymiarach min. 400 x 400 x 60 mm z konglomeratu kwarcowo - granitowego posadowiony na wibroizolatorach. 	1	RUCHOME	
B3	<p><u>STÓŁ WYSPOWY Z BLATEM LABORATORYJNYM CHEMOODPORNYM, NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM LED ORAZ CZĘŚCIOWO SZAFKAMI POD BLATEM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary stołu: 360x150x90 cm; - lokalizacja zgodnie z ZAŁ. 3; - stelaż metalowy typ C, lakierowany proszkowo, regulowane stopki; - blat z żywicy fenolowej min 19 mm; - na blacie nadstawka kolumnowa wysoka o długości 2400 mm; - trzy kolumny lakierowane proszkowo, - w każdej kolumnie 6 gniazd min. IP44 - po 3 gniazda na stronę, gniazda rozmieszczone zgodnie z ZAŁ. 2; - dwa poziomy półek wykonanych ze szkła bezpiecznego, z brzegiem zapobiegającym spadaniu przedmiotów, - pod dolnymi półkami oświetlenie listwą LED z obu stron na całej długości; - lokalizacja nadstawki zgodnie z ZAŁ. 3; - pod blatem szafki podwieszane o szer.: 600 mm typ 3 szuflady (2 szuflady niskie, 1 wysoka) x 2 szt.; 600 mm typ 1 drzwi x 4 szt.. <p>Poglądowe rozmieszczenie szafek zawarto na schemacie stanowiącym ZAŁ. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na blacie zainstalowane 2 gniazda wtykowe 230 V chowane w blacie – zabezpieczone przed zachłapaniem – lokalizacja zgodnie z ZAŁ 3. 	1	STAŁE	<p>PODŁĄCZENIE DO PRĄDU – INSTALACJA GNIAZD NA SŁUPKACH NADSTAWKI ORAZ W BLACIE;</p> <p>PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ;</p> <p>ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW;</p>

	<p>+ <u>1 x ZLEW CERAMICZNY ZAINSTALOWANY NA BLACIE</u> - lokalizacja zlewu i baterii zgodnie z ZAŁ. 3, - wymiary wewnętrzne (komora zlewu): długość: od 250 do 300 mm, szerokość: od 90 do 120 mm, głębokość: od 100 do 120 mm; - z syfonem; - kolor: szary; - nad zlewem bateria nablatowa zgodnie ze specyfikacją z wymagań ogólnych.</p> <p>Od czoła wyspy stół bez zabudowy, stanowisko do filtracji (oznaczone jako 6 w ZAŁ. 3) z możliwością siedzenia z 3 stron.</p>			
B4	<p><u>STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLATEM LABORATORYJNYM CHEMOODPORNYM ORAZ SZAFKAMI POD BLATEM ZABUDOWA W UKŁADZIE "L"</u> - wymiary blatu: szer.: 300/310 cm; gł.: 75 cm; wys.: 90 cm; - blat z żywicy fenolowej o grubości min. 19 mm; - stelaż metalowy typ A, lakierowany proszkowo, , profil min. 50x30x3 mm, regulowane stopki; - gniazdo konferencyjne w blacie 3 x 230 V - 2 zestawy – lokalizacja zgodnie z ZAŁ. 3; - pod blatem szafki o szer. : 1200 mm typ narożna x 1 szt., 800 mm typ 2 x drzwi x 1 szt. (z półką), 800 mm typ 2 x drzwi x 1 szt. (bez półki), 500 mm typ 3 szuflady (2 szuflady niskie, 1 wysoka) x 3 szt., 600 mm typ 3 szuflady (2 szuflady niskie, 1 wysokie) x 1 szt., 600 mm typ 1 drzwi x 2 szt.</p> <p>Głębokość szafek na tym stanowisku musi umożliwić montaż kanalizacji na ścianie pod blatem.</p> <p>Poglądowe rozmieszczenie szafek zawarto na schemacie stanowiącym ZAŁ. 2.</p> <p>+ <u>1 x ZLEW CERAMICZNY ZAINSTALOWANY NA BLACIE (POD ŚCIANA)</u> - lokalizacja zlewu i baterii zgodnie z ZAŁ. 3; - zlew ceramiczny laboratoryjny - wymiary wewnętrzne (komora zlewu): długość: od 250 do 300 mm, szerokość: od 90 do 120 mm, głębokość: od 100 do 120 mm; - z syfonem; - kolor: szary;</p>	1	STAŁE	<p>PODŁĄCZENIE DO PRĄDU – GNIAZDA W BLACIE;</p> <p>PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ;</p> <p>ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW;</p>


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

	- nad zlewem bateria nablatowa zgodnie ze specyfikacją z wymagań ogólnych.			
B5/B5.1	<p>STANOWISKO DO ZMYWANIA STÓŁ Z BLATEM LABORATORYJNYM CHEMOODPORNYM</p> <p>- wymiary blatu: szer.: 145 cm; gł.: 75 cm; wys.: 90 cm; - blat z żywicy fenolowej o grubości min. 19 mm; - stelaż metalowy typ H, profil min. 50x30x3 mm lakierowany proszkowo, regulowane stopki; - podniesione obrzeże dookoła blatu B5 (o wymiarach 600x750 mm), w którym będzie zamontowany zlew; - szafki pod blatem: 600 mm – wysuwana szuflada na śmietniki pod blatem B5 wraz z dwoma śmietnikami o jak największej pojemności mieszczące się w szufladzie; 850 mm - dwudrzwiowa pod blatem B5.1. (bez półki) – wymagane wycięcie otworu w kształcie kwadratu (ok. 250x250 mm – dokładne wymiary otworu do uzgodnienia po wizji lokalnej i pomiarach Wykonawcy) w prawym boku szafki, w celu umożliwienia dostępu do drzwi rewizyjnych (FOT.1.).</p> <p>Poglądowe rozmieszczenie szafek zawarto na schemacie stanowiącym ZAŁ. 2. + ZLEW CERAMICZNY ZAINSTALOWANY NA BLACIE</p> <p>- lokalizacja zlewu zgodnie z ZAŁ. 3 - zlew ceramiczny laboratoryjny - zlew musi mieścić się na blacie B5; - wymiary wewnętrzne (komora zlewu): długość: od 450 do 500 mm, szerokość: od 350 do 400 mm, głębokość: od 230 do 300 mm; - z syfonem; - kolor: biały; - zlew podparty; - nad zlewem bateria nablatowa zgodnie ze specyfikacją z wymagań ogólnych; - przy stanowisku do zmywania pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej: pojemność min. 500 listków zamknięcie Zamek i kluczyk plastikowy kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku.</p>	1	STAŁE	<p>PRZYŁĄCZE WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ; ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW;</p>
B6	<p>STANOWISKO DO ZMYWANIA STÓŁ Z BLATEM LABORATORYJNYM CHEMOODPORNYM</p>	1	STAŁE	<p>PRZYŁĄCZE WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ;</p>

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu: szer.: 145 cm; gł.: 75 cm; wys.: 90 cm; - blat z żywicy fenolowej o grubości min 19 mm; - podniesione obrzeże dookoła całego blatu; - stelaż metalowy typ A, lakierowany proszkowo, regulowane stopki; - pod blatem: szafka o szer. 650 mm - instalacyjna pod zlew (dwudrzwiowa) (bez półki); szafka o szer. 400 mm typ 1x drzwi x 2 szt. - kosz na śmieci o maksymalnie dużej pojemności do umieszczenia pod blatem. <p>Poglądowe rozmieszczenie szafek zawarto na schemacie stanowiącym ZAŁ. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na ścianie nad zlewem ociekacz ścienny kołkowy z kanałem odpływowym o wymiarach około 500x500 mm - 2 szt.; - ociekacz laboratoryjny polistyrenowy o wysokiej odporności chemicznej, do suszenia naczyń różnej wielkości. Wyjmowane trzpienie o różnych średnicach, możliwość konfiguracji układu trzpieni; - kolor ociekacza: jasnoszary. <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;"><u>ZLEW CERAMICZNY ZAINSTALOWANY NA BLACIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lokalizacja zlewu zgodnie z ZAŁ. 3 - zlew ceramiczny laboratoryjny - zlew musi mieścić się na blacie B5; - wymiary wewnętrzne (komora zlewu): długość: od 450 do 500 mm, szerokość: od 350 do 400 mm, głębokość: od 230 do 300 mm; - z syfonem; - kolor: biały; - zlew podparty; - nad zlewem bateria nablatowa zgodnie ze specyfikacją z wymagań ogólnych; - przy stanowisku do zmywania pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej: pojemność min. 500 listków zamknięcie Zamek i kluczyk plastikowy kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku. 			<p>ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW;</p>
<p>B7</p>	<p><u>STÓŁ PRYŚCIENNY Z BLATEM LABORATORYJNYM CHEMOODPORNYM ORAZ ZAMYKANymi SZAFKAMI POD BLATEM ZABUDOWA W UKŁADZIE "L"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu: szer. 299/120 cm; gł. 75 cm; wys. 90 cm; - blat z żywicy fenolowej min 19 mm; - stelaż metalowy typ A, profil min. 50x30x3 mm lakierowany proszkowo, regulowane stopki; 	<p>1</p>	<p>STAŁE</p>	<p>PODŁĄCZENIE DO PRĄDU – GNIAZDA W BLACIE;</p> <p>PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ;</p> <p>ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW;</p>

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.


	<p>- szafki podwieszane: 1200 mm narożna 1 drzwiowa x 1 szt.; 600 mm - 3 szuflady (2 szuflady niskie, 1 wysoka) x 2 szt.; 600 mm - 1 drzwi x 2 szt.; 590 mm - 1 drzwi x 1 szt.;</p> <p>- w blacie: - gniazdo konferencyjne w blacie 2 x 230 V i 1 x LAN - 1 szt. - lokalizacja gniazda zgodnie z ZAŁ. 3.</p> <p>Głębokość szafek na tym stanowisku musi umożliwić montaż kanalizacji na ścianie pod blatem.</p> <p>Poglądowe rozmieszczenie szafek zawarto na schemacie stanowiącym ZAŁ. 2.</p> <p>+ <u>ZLEW CERAMICZNY ZAINSTALOWANY NA BLACIE (POD ŚCIANA)</u> - lokalizacja zlewu i baterii zgodnie z ZAŁ. 3; - zlew ceramiczny laboratoryjny - wymiary wewnętrzne (komora zlewu): długość: od 250 do 300 mm, szerokość: od 90 do 120 mm, głębokość: od 100 do 120 mm; - z syfonem; - kolor: szary; - nad zlewem bateria nabladowa zgodnie ze specyfikacją z wymagań ogólnych.</p>			
K1	<p><u>KRZESŁO LABORATORYJNE WYSOKIE DO STANOWISK KOMPUTEROWYCH h = 90 cm</u> Krzesła do stanowisk komputerowych – opisane w wymaganiach ogólnych.</p>	2	RUCHOME	
K2	<p><u>KRZESŁO LABORATORYJNE WYSOKIE DO STOŁÓW h = 90 cm</u> Krzesła do stanowisk siedzących przy wyspie – opisane w wymaganiach ogólnych.</p>	6	RUCHOME	
S2	<p><u>STANOWISKO KOMPUTEROWE</u> - wymiary: szer.: 150 cm; gł.: 75 cm; wys.: 90 cm - stelaż metalowy typ C, lakierowany proszkowo, regulowane stopki; - blat z żywicy fenolowej min 19 mm.</p> <p>+ <u>MOBILNY KONTENEREK BIUROWY Z ZAMYKANymi TRZEMA SZUFLADAMI W PRZESTRZENI PODBLATOWEJ BIURKA</u> - 1 x szafka mobilna o szer. 600 mm z 3 szufladami zamykanymi na kluczyk.</p>	1	RUCHOME	
B8	<p><u>STÓŁ LABORATORYJNY POD MIKROSKOP</u> - wymiary: szer. 90 cm; gł.: 75 cm; wys.: 90 cm; - stelaż spawany w całości z profili stalowych min. 50x30x3 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi;</p>	1	RUCHOME	



	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa stołu wykonana z płyt o grubości min. 18 mm; - obudowa bez punktów stykowych ze stelażem; - 1 x kamień z konglomeratu kwarcowo - granitowego posadowiony na wibroizolatorach odpowiedni pod mikroskop o wymiarach 500x430x280 (dł. x szer. x gł.) 			
SZ1	<p><u>SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA SZKŁA, ODCZYNNIKÓW, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary szafy mają umożliwiać swobodne przejście pomiędzy szafką a stołem wyspowym, przykładowe wymiary: szer. 120 cm; gł. 45 cm; wys. 190-210 cm; - szafka zamykana, dwudrzwiowa; - drzwi pełne – prawe i lewe; - 4 półki regulowane w każdej części; - wykonana z płyt obustronnie laminowanych zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla szaf; - dopuszczalne obciążenie półek do 40 kg; - kolor jasnoszary, zbliżony do NCS S 1000N. 	1	RUCHOME	
SZ2	<p><u>SZAFKA DO PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU I PRÓB</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer.: 90 lub 100 cm; gł.: 60 cm; wys.: 190 cm; - podział pionowy; - drzwi pełne prawe i lewe; - 4 półki regulowane w każdej części; - szafka zamykana; - szafka metalowa; - dopuszczalne obciążenie półek do 40 kg; - kolor jasnoszary, zbliżony do NCS S 1000N. 	1	RUCHOME	
R1	<p><u>METALOWY REGAŁ Z PERFOROWANYMI SŁUPAMI I PÓŁKAMI OSADZONYMI W PERFORACJI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: szer. 80 cm; gł. 40 cm; wys. 200 cm; - słupki pionowe perforowane; - półki metalowe (5 półek) - obciążenie 100 kg na półkę, - kolor jasnoszary, zbliżony do NCS S 1000N. 	2	RUCHOME	


*Zastosowane symbole są zgodne z rysunkami stanowiącymi Załączniki 2 i 3 do przedmiotowego zapytania ofertowego.



FOT. 1. Zdjęcie drzwiczek rewizyjnych przy stanowisku do zmywania B5/B5.1

Pomieszczenie 0/02

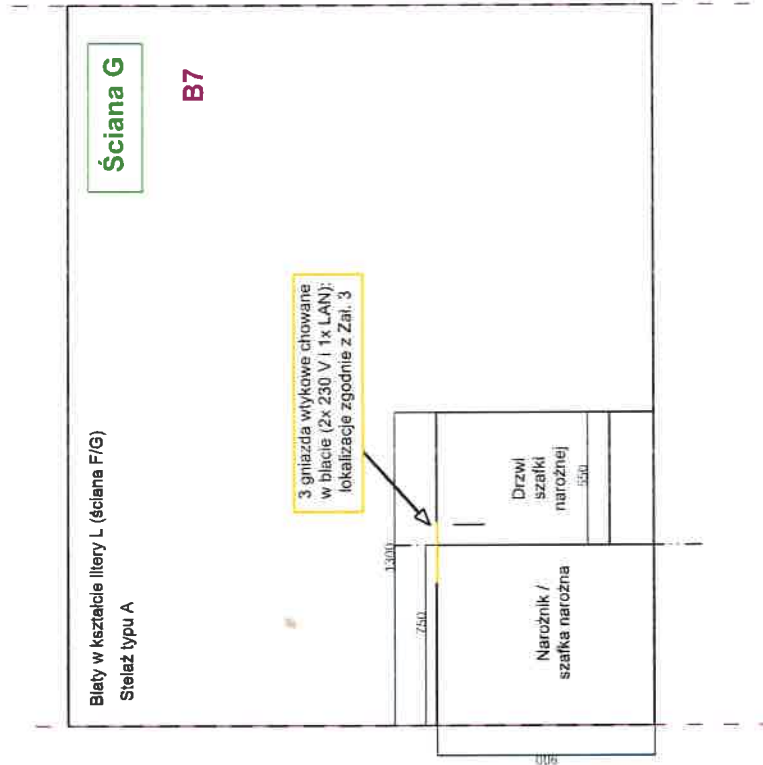


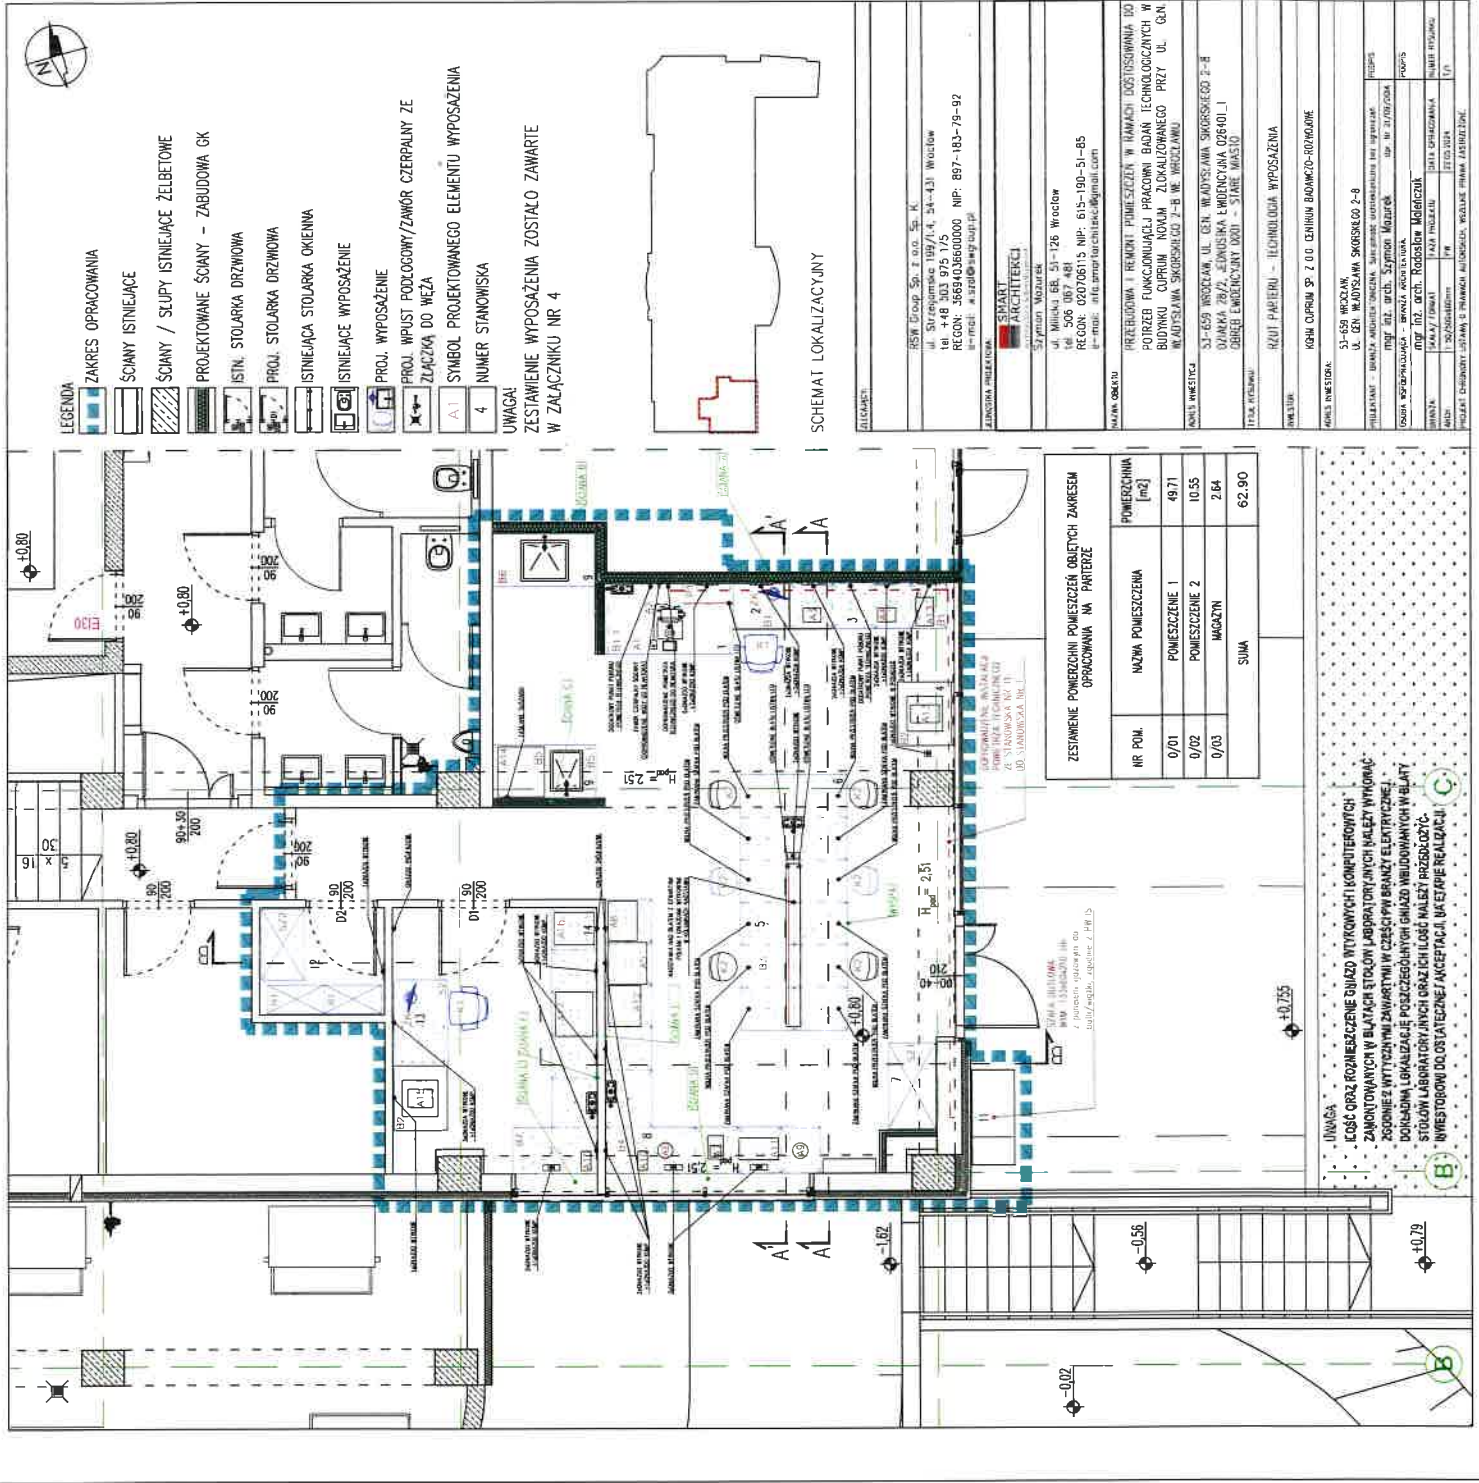

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY / SŁUPY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY - ZABUDOWA GK
- ISTN. STOLARKA DRZWIOWA
- PROJ. STOLARKA DRZWIOWA
- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
- ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE
- PROJ. WYPOSAŻENIE
- PROJ. WPISY PODŁOGOWY/ZNIÓR CZERPAŁNY ZE ZŁĄCZKA DO WEZA
- SYMBOL PROJEKTOWANEGO ELEMENTU WYPOSAŻENIA
- NUMER STANOWISKA

UWAGA!
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZOSTAŁO ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU NR 4



SCHEMAT LOKALIZACYJNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIĘDZY OGRZEWANIA NA PARTERZE

NR POL.	NAZWA POMIĘDZY OGRZEWANIA	POWIERZCHNIA [m ²]
0/01	POMIĘDZY 1	49,71
0/02	POMIĘDZY 2	10,55
0/03	MAGAZYN	2,64
SUMA		62,90

UWAGA
ILOŚĆ ORAZ ROZMIESZCZENIE GUM DO WYKONYWANIA PRAC WYKONAWCZYCH W BIAŁYCH STÓŁKACH LABORATORYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI PW BRANŻY ELEKTRYCZNEJ. DOKŁADNA LOKALIZACJA I POZOSTAŁYCH GŁAWIŚC WILKUDOWYCH W RELATYWIE STÓŁKACH LABORATORYJNYCH ORAZ ICH ILOŚĆ NALEŻY PRZEDSUDZIĆ WNIOSIENIEM DO OSTATNIEJ AKCEPTACJI DANEJ PRZEZ REALIZACJĘ.

SMART ARCHITECTS
Szymon Mozurk
ul. Miłkacza 6B, 51-126 Wrocław
tel. 48 71 303 975 1/5
REGON: 36694036600000 NIP: 897-183-79-92
e-mail: a.broch@smart-arch.pl

SMART ARCHITECTS
Szymon Mozurk
ul. Miłkacza 6B, 51-126 Wrocław
tel. 48 71 303 975 1/5
REGON: 36694036600000 NIP: 897-183-79-92
e-mail: a.broch@smart-arch.pl

INWESTOR
GEN. WADYSŁAW SKORSKI 2-B
ul. Główna 78/2, Jednostka Emerycjanka 02640_1
OBRĘB EMERYCJANKI 0201 - STARE WĄSIO

PROJEKTOWY
RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA

INWESTOR
KOPR OPRIM SP. Z O.O. CENTRUM BUDOWCO-ROZKOPARNE
ul. Główna 51-659 WROCŁAW
ul. GEN. WADYSŁAW SKORSKI 2-8
WROCŁAW

PROJEKTOWY
mgr inż. arch. Szymon Mozurk
ul. W. 21/101/004

OPRACOWANIE
mgr inż. arch. Radosław Mielczon
ul. Główna 51-659 WROCŁAW

OPRACOWANIE
mgr inż. arch. Radosław Mielczon
ul. Główna 51-659 WROCŁAW

OPRACOWANIE
mgr inż. arch. Radosław Mielczon
ul. Główna 51-659 WROCŁAW

OPRACOWANIE
mgr inż. arch. Radosław Mielczon
ul. Główna 51-659 WROCŁAW

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.
E-mail:
Osoba do kontaktu
Nr rachunku bankowego do zapłaty

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo -Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu, wykonanie, dostawę, montaż i podłączenie do wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, zlewów i armatury dla Pracowni Badań Technologicznych w budynku Cuprum NOVUM

przedstawiam ofertę:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- a) wykonanie projektu i wykonanie/dostawa mebli laboratoryjnych, zlewów i armatury,
 - b) montaż i podłączenie przedmiotu zamówienia do wszystkich instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach 1,2 i 3

II. CENA I TERMINY WYBORU OFERTY

Cena netto za całość przedmiotu zamówienia , PLN
Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia , PLN

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”. ”

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

w tym podatek VAT w wysokości%
Słownie kwota netto:;
Termin ważności oferty	30 dni
Termin płatności	Przelew 60 dni
Termin realizacji zamówienia	maksymalnie do 9 tygodni od daty podpisania umowy, przy czym realizacja Etapu I nie może być dłuższa niż do 2 tygodni od dnia podpisania Umowy;

III. Okresy gwarancji

Przedmiot zamówienia powinien posiadać min. 12 –miesięczny okres gwarancji na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia, w tym na użyte materiały i poszczególne elementy mebli, osprzętu i armatury, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym zapytaniu.

Gwarancja miesięcy
-----------	----------------

IV. DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zdobyte w wykonaniu minimum 3 zadań obejmujących wyposażenie pomieszczeń pracowni/laboratoryjnych o zbliżonych i/lub większych powierzchniach oraz zbliżonym stopniu złożoności co przedmiot oferty wraz z montażem, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 4 lata, w tym okresie.

DOŚWIADCZENIE ZA OKRES MIN. 4 LAT	L.P.	NAZWA FIRMY DLA KTÓREJ WYKONANO USŁUGĘ	ADRES FIRMY DLA KTÓREJ WYKONANO USŁUGĘ	ROK WYKONANIA USŁUGI
	1.			
	2.			
	3.			

UWAGA : Na potwierdzenie powyższego do oferty zostaną dostarczone referencje i dokumenty potwierdzających wykonanie w/w usług

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

V. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że:
 - a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
 - b) spełniam warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonaniu min. 3 zadań obejmujących wyposażenie pomieszczeń pracowni/laboratoryjnych o zbliżonych i/lub większych powierzchniach oraz zbliżonym stopniu złożoności co przedmiot oferty wraz z montażem, zrealizowanych w okresie 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 4 lata, w tym okresie. Na potwierdzenie powyższego załączam do oferty dokument świadczący o wykonaniu minimum 3 usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 - c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania,
 - d) znajduję się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej
 - e) wobec mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostają w upadłości
 - f) nie zalegam ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS (jeśli dotyczy)
 - g) nie znajduję się w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy
 - h) posiadam aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł oraz potwierdzenie opłacania składek za ww. polisę.
2. Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym nr 16/08/2024 z dnia 08.08.2024 r., dalej jako Zapytanie ofertowe.
3. Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe, bezszkodowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem możliwości zadania pytań dotyczących zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania przetargowego.
6. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzwane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem się z Polityką Antykorupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kg hm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie <https://kg hmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcyjna-kg hm-cuprum-sp-z-o-o-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.
7. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zarówno Oferent, jego reprezentanci jak i jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.

8. Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
- b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kgmcuprum.com
- c) Administrator Danych Osobowych przetwarza:
 - a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciężących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem.
 - b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy.
 - c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy.
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- e) Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- f) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Dostawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
- g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - ✓ prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - ✓ usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - ✓ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - ✓ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących; -o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
- i) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

Oświadczam, że integralną część oferty stanowią następujące załączniki:

1. Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika – dotyczy / nie dotyczy (niepotrzebne skreślić)
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – stanowiące Załącznik nr 5

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

3. Dokument potwierdzający wykonanie minimum 3 prac/zadań zgodnych z przedmiotem zamówienia.
4. Dokument polisy OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składek
5. Inne.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
Dostawcy/Wykonawcy

Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePuap lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr DZ/16/08/2024

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.
E-mail:
Osoba do kontaktu

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Oświadczam/y, że Dostawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej

Wrocław,2024 r.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

..... z siedzibą w

ul., KRS, NIP

oświadcza:

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy, w szczególności do nie rozpowszechniania, publikowania, ujawniania w żaden inny sposób, wszelkich informacji, treści dokumentów, projektów itp., które nie są uznane za jawne, niezależnie od formy ich przekazania bądź utrwalenia, uzyskanych w związku z zapytaniem dotyczącym przedstawienia oferty na przygotowanie projektu, wykonanie, dostawę, montaż i podłączenie do wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, zlewów i armatury dla Pracowni Badań Technologicznych w budynku Cuprum NOVUM
2. Informacjami jawnymi są informacje, które:
 - 1) jeszcze przed podpisaniem niniejszej klauzuli są lub staną się dostępne publicznie bez winy Podpisującego Zobowiązanie, jego pracowników lub podwykonawców i doradców,
 - 2) są lub staną się dostępne dla Podpisującego z innego źródła, aniżeli, KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR pod warunkiem, że podmiot będący źródłem informacji nie był związany z KGHM CUPRUM ograniczeniami nakładanymi przez Zobowiązanie lub porozumienia o poufności,
 - 3) były w posiadaniu Podpisującego przed podpisaniem Zobowiązania pod warunkiem, że podmiot, który był ich źródłem nie był związany klauzulami lub porozumieniem o poufności z KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR.
3. Podpisujący podejmie odpowiednie kroki, aby zapobiec ujawnieniu informacji, dokumentów, o których mowa w pkt 1 osobom nieupoważnionym lub innemu ich wykorzystaniu bez pisemnego pozwolenia, przez pracowników, współpracowników, podwykonawców, czy inne osoby, które mają do nich dostęp za pośrednictwem Wykonawcy.
4. Obowiązki wynikające z niniejszego ZOBOWIĄZANIA wiążą przez okres 5 lat od daty jego podpisania.

.....
podpis osoby upoważnionej